



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

2/SPMJU/2018

Kraków 25.01.2018r.

Odpowiedzi 2 na zapytania złożone do postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Pytanie 1:

Część nr 1, poz. 26-31

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź 1:

NIE

Pytanie 2:

Część nr 1, poz. 32

Czy Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu z opatrunkiem do kaniul? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź 2:

NIE

Pytanie 3:

Część nr 1, poz. 33

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8x6 cm, w opakowaniu a'100 szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 3:

NIE

Pytanie 4:

Część nr 1, poz. 33-34

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź 4:

NIE

Pytanie 5:

Część nr 1, poz. 33-34



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Proszę o dopuszczenie kaniuli neonatologicznych wykonanych z PUR lub z FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 5:

NIE

Pytanie 6:

Część nr 1, poz. 35-39

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź 6:

NIE

Pytanie 7:

Część nr 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego

Odpowiedź 7:

NIE

Pytanie 8:

Część nr 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,0 x 45	290
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 32	110
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G o długości 32mm. Pozostałe parametry i rozmiary innych kaniul zgodnie z siwz

Pytanie 9:

Część nr 1, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z 3 paskami radio-cieniującymi, w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,1 x 45	270



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

16 G	1,80 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,30x 45	85
20 G	1,1 x 32/33	55
22 G	0,90 x 25	33

Odpowiedź 9:

NIE

Pytanie 10:

Część nr 1, poz. 67-70

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź 10:

NIE

Pytanie 11:

Część nr 1, poz. 69

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC.

Odpowiedź 11:

NIE

Pytanie 12:

Część nr 1, poz. 94-100

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź 12:

NIE

Pytanie 13:

Część nr 1, poz. 95

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za strzykawkę pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź 13:

TAK

Pytanie 14:

Część 2: Igły doszpikowe



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności najnowsze automatyczne wkłucie doszpikowe NIO dla osób dorosłych i dzieci po 12 roku życia oraz wkłucie doszpikowe NIO pediatryczne dla dzieci do 12 roku życia, o poniższych parametrach:

- Automatyczne, sprężynowe
- Umożliwiające dostęp doszpikowy i podaż leków, płynów, krwi
- Możliwość zastosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia (model dla osób dorosłych)
- Możliwość zastosowania u dzieci do 12 roku życia (model pediatryczny)
- Jednorazowego użytku, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne
- Możliwość uzyskania szybkiego dostępu doszpikowego do 10s
- Możliwość wykonania wkłucia w 2 miejscach: kość piszczelowa, głowa kości ramienia (model dla dorosłych)
- Możliwość wykonania wkłucia w kości piszczelowej (model pediatryczny)
- Stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji
- Do natychmiastowego użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania
- Rozmiar igły 15G (model dla dorosłych)
- Rozmiar igły 18G (model pediatryczny)
- Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia
- Bezpieczne w użyciu – brak dostępu do igły, brak ryzyka zakłucia
- Oryginalna etykieta producenta w języku polskim

Wyjaśniamy, iż w związku z prowadzeniem nowego produktu aparatu doszpikowego NIO następcy aparatu doszpikowego BIG, producent ograniczył dostępność starszego urządzenia (BIG) na rynku. Nowy model jest urządzeniem udoskonalonym przez producenta, umożliwiającym dostęp doszpikowy w przeciągu ok. 10 sek. i praktycznie natychmiastową podaż leków/płynów. Zmiany dotyczą stabilizacji igły po wykonanym zabiegu – stabilizator umiejscowiony jest na igle (nie ma potrzeby używać dodatkowych elementów z zestawu), okres przydatności do użycia od daty produkcji wynosi 5 lat, dodatkowo w przypadku wkłucia doszpikowego pediatrycznego zmieniony został sposób wyznaczania miejsca wkłucia przez osobę wykonującą zabieg – wystarczy wyznaczyć guzowatość kości piszczeli i przyłożyć pistolet.

Odpowiedź 14:

TAK

Pytanie 15:

Część 2: Igły doszpikowe

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone igły doszpikowe „jednorazowy aparat automatyczny” posiadały, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski, odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego?



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 15:

Igły doszpikowe mają mieć etykietę/ulotkę /instrukcję w języku polskim.

Nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela ma być podana na opakowaniu lub na ulotce,

Pytanie 16:

Część 2: Igły doszpikowe

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie Polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych i potwierdził to odpowiednim dokumentem autoryzacyjnym od producenta

Odpowiedź 16:

NIE

Pytanie 17:

Część nr 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu w opakowaniach papierowych pokrywanych od wewnątrz powłoką foliową.

Odpowiedź 17:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany sposób pakowania, nie zmienia natomiast wymogu dotyczącego metody sterylizacji

Pytanie 18:

Część nr 4, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

- chlorowanych, nie pokrywanych polimerem;
- o grubości ścianki dłoni 0,05mm;
- o poziomie AQL=1,5;
- posiadających protokoły z badań ASTM F 1671 z 2014 r.;
- o sile zrywu przed starzeniem min. 6N zgodnie z EN 455-2.

Odpowiedź 18:

NIE

Pytanie 19

Część 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie nakłuwaczy jednorazowego użytku będących przedmiotem Zamówienia Część 1 pozycje 61 i 62 do osobnej części?

Odpowiedź 19:

NIE

Pytanie 20



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy w opakowaniu papier-folia.

Odpowiedź 20:

TAK

Pytanie 21

Pakiet 4, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy sterylizowanej tlenkiem etylenu.

Odpowiedź 21:

NIE

Pytanie 22

Pakiet 4 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na potwierdzenie przebadania rękawic na przenikanie wirusów raportu z badań wykonanych w niezależnej jednostce z 2013r. Badania tego typu, z uwagi na wysokie koszty są wykonywane dla konkretnej marki, nie dla każdej serii rękawic – dlatego też rękawice dłużej funkcjonujące na rynku posiadają starsze badania, których wyniki są nadal aktualne. W związku z powyższym prosimy o przychylenie się do prośby i dopuszczenie badań na przenikania wirusów wykonanych w jednostce niezależnej z 2013r.

Odpowiedź 22:

NIE

Pytanie 23

Pakiet 4 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o zaoferowanie rękawic pakowanych a'200szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź 23:

NIE

Pytanie 24

Pakiet 4 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ rozdział VII pkt 1.8 tj wymóg III kategorii środków ochrony indywidualnej czy dotyczy tylko pakietu 4 pozycja 2?

Odpowiedź 24:

TAK

Pytanie 25

Pytania dotyczące zapisów umowy:

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 7 ust. 3 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź 25:



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

NIE

Pytanie 26

Pytania dotyczące zapisów umowy:

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 50 zł w § 9 ust. 1 lit. a), b), 5 % w § 9 ust. 1 lit. c). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź 26:

NIE

Pytanie 27

Pytania dotyczące zapisów umowy

Prosimy o zmianę § 12 ust. 3 pkt 1) projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w tym również m.in. zmian obowiązującej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź 27:

NIE

Pytanie 28

Pytania dotyczące zapisów umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 12 ust. 3 pkt 5) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź 28:

NIE

Pytanie 29

Pytania dotyczące zapisów umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu § 13 ust. 1 projektu umowy.

Odpowiedź 29:

NIE

Pytanie 30

Pytania dotyczące zapisów umowy

Prosimy o modyfikację § 13 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób: „Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego (art. 54 ust. 5 ustawy o działalności



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

lecniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, nr 112, poz. 654)). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna.

Odpowiedź 30:

NIE

Pytanie 31

Część 1, poz. 32

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek posiadał klasę IIA dzięki czemu zapewnia stabilne mocowanie kaniul w miejscu wkłucia zmniejsza ryzyko infekcji i powstawania stanów zapalnych? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 31:

TAK

Pytanie 32

Część 1, poz. 41-46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki do laryngoskopu pakowane w pokrowiec folia/folia?


Odpowiedź 32:

TAK

Pytanie 33

Część 1, poz. 41-46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki do laryngoskopu o wymiarach podanych poniżej?

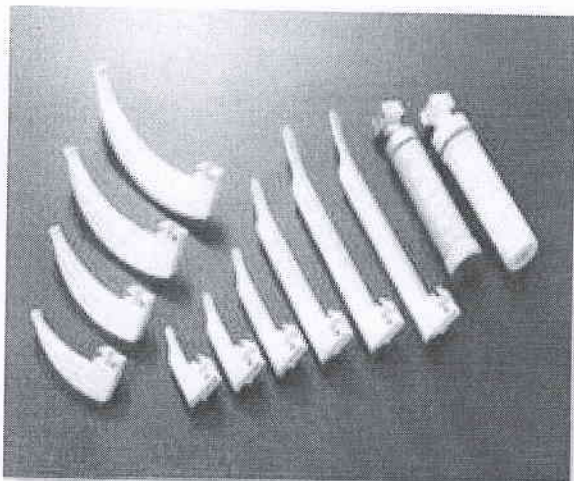

SLN-0306 (OPTICAL FIBER BLADE-NEW)

	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Miller #00	17	63.5	32.6
Miller #0	18	79	32.6
Miller #1	19	105	32.6
Miller #2	22	158.5	36
Miller #3	23	197.8	36
Miller #4	24	206.4	38
Macintosh #4	27.7	157	46
Macintosh #3	26.8	138.9	45
Macintosh #2	23.4	115.9	40.9
Macintosh #1	20	95	38.7

Odpowiedź 33:

TAK

Pytanie 34

Część 1, poz. 41-46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki do laryngoskopu pakowane w pokrowiec folia/papier?

Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001, NIP 675-11-98-968

 MAŁOPOLSKA



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 34:

TAK

Pytanie 35

Część 1, poz. 41-46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łyżki do laryngoskopu o wymiarach podanych poniżej?

Description	Length (mm)	Width (mm)	High (mm)
Disposable blade, MAC #1	94.9	38.7	20.1
Disposable blade, MAC #2	116	40.9	23.5
Disposable blade, MAC #3	138.9	45.1	26.8
Disposable blade, MAC #4	157	65.5	27.8
Disposable blade, MIL #00	63.5	32.6	17
Disposable blade, MIL #0	79.1	32.6	18
Disposable blade, MIL #1	105.1	32.6	19
Disposable blade, MIL #2	158.7	34.8	22
Disposable blade, MIL #3	197.8	35.9	

Odpowiedź 35:

TAK

Pytanie 36

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 20

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w rozm. 43x46 mm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 36:

TAK, Zamawiający dopuszcza elektrody o zaproponowanym rozmiarze

Pytanie 37

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 poz. 21

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w rozm. 39x36 mm lub 30 mm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 37:

TAK, Zamawiający dopuszcza elektrody o zaproponowanym rozmiarze 39x36 mm

Pytanie 38

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1 poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody w rozm. 41x37 mm z żelom ciekłym spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 38:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych elektrod i nie wydziela tej pozycji.

Pytanie 39

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1 poz. 25

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 39:

NIE

Pytanie 40

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 1 poz. 33

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dla noworodka bez zdejmowalnego uchwytu z standardowy portem 24 G 0,7x19 przepływ 20 mm/min.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 40:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych kaniul i nie wydziela tej pozycji.

Pytanie 41

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 1 poz. 34

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP bez portu rozm. 26 G 0,6x19 mm przepływ 17 ml/min spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 41:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych kaniul i nie wydziela tej pozycji.

Pytanie 42

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 1 poz. 41

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżek pakowanych w pokrowiec folia/papier o długości 105 mm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 42:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43

Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 1 poz. 42



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżek pakowanych w pokrowiec folia/papier o długości 115,9 mm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 43:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 1 poz. 43

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżek pakowanych w pokrowiec folia/papier o długości 138,9 mm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 44:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 1 poz. 44

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżek pakowanych w pokrowiec folia/papier o długości 79 mm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 45:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 1 poz. 45

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżek pakowanych w pokrowiec folia/papier o długości 105 mm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 46:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 1 poz. 46

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżek pakowanych w pokrowiec folia/papier o długości 157 mm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 47:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 1 poz. 99 i 100



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pomp strzykawkowych z końcówką luer lock z czterostronnym podcięciem na tłoku o pojemności 50/60 ml spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

Prośbę swą kierujemy ponieważ prostopadły wycięcie na tłoku było wymagane w pompach starego typu, które zostało wycofane z użytkowania. W związku z tym zapis ten nie ma żadnego uzasadnienia. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź 48:

Zamawiający dopuszcza

Wszystkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Otrzymują:
Wykonawcy, strona internetowa

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Marek Maślerz